JIZAI製品ラインナップ マルチプルユース

規格	サイズ	テーパー	長さ	入数	標準価格
グライドパスキット					
オリフィスオープナー 	025	14	18mm	各1本入	6,000円
Pre 013	013	04	21mm 25mm		
Pre 020	020	04			
シェイピングキット					
Ⅰ	025	04	21mm 25mm	各1本入	6,000円
Ⅱ	025	06			
Ⅲ	035	04			

規格	サイズ	テーパー	長さ	入数	標準価格
単品					
オリフィスオープナー	025	14	18mm	3本入	6,000円
Pre 013	013	04	21mm 25mm		
Pre 020	020	04			
025 04	025	04			
030 04	030	04			
035 04	035	04			
040 04	040	04			
045 04	045	04			
050 04	050	04			
025 06	025	06			
030 06	030	06			
035 06	035	06			

医療機器認証番号：301ABBZX00035000　管理医療機器　一般的名称：電動式歯科用ファイル　販売名：マニー NiTi ファイル

サイズ識別

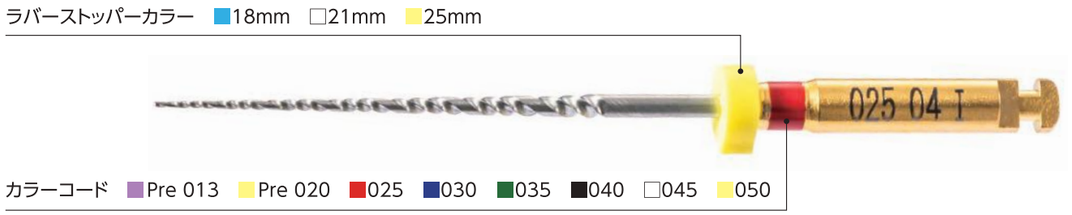

関連製品

Dファインダー

サイズ　08,10,12,15
長さ　21mm, 25mm

医療機器届出番号：09B1X00006011050
一般医療機器
一般的名称：歯科用ファイル
販売名：マニー Dファインダー

グライドファインダー

サイズ　08,10,12,15
長さ　21mm, 25mm

医療機器届出番号:09B1X00006011010
一般医療機器
一般的名称:歯科用ファイル
販売名:マニー Kファイル

製造販売 マニー株式会社
〒321-3231　栃木県宇都宮市清原工業団地８番３
【デンタル国内営業】Tel.028-667-8591 ／ Fax.028-667-8593

発売 株式会社モリタ
大阪本社　〒564-8650　大阪府吹田市垂水町３丁目33番18号　Tel:06-6380-2525
東京本社　〒110-8513　東京都台東区上野２丁目11番15号　Tel:03-3834-6161

D02003

MANI

jiZAi
— 自 在 —

NiTi ロータリーファイル

より安全、より快適な、操作性の追求

根管治療の悩みを解決するために

日々の治療において、より安全・より快適に使用できるファイルを追求し、私たちは「操作性」、「耐久性」、「追従性」をキーワードに“JIZAI”を開発いたしました。
弯曲根管へのアプローチに信頼できるサポートを提供することが、皆さまの負担軽減と安心につながるように。

JIZAI
— 自 在 —
NiTi ロータリーファイル

デザイン

引き込まれを大幅に軽減した操作性

番手によって適切な断面形状を付与しています。

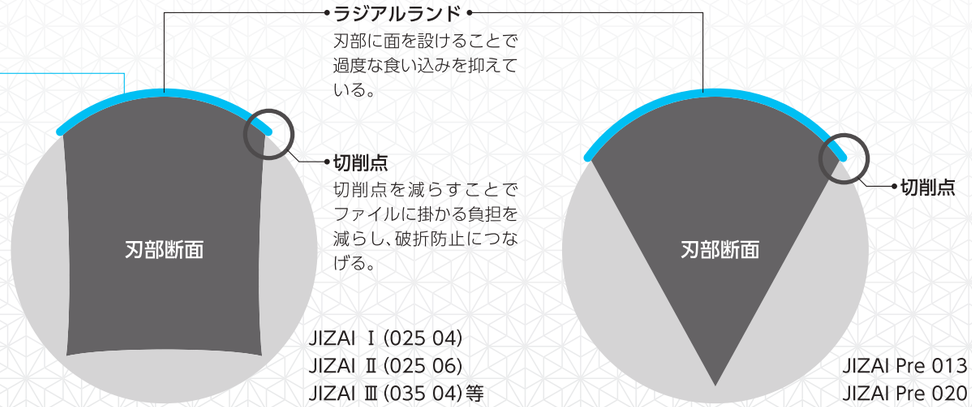

破折への不安解消を目指した耐久性

熱処理によって適切な柔軟性を付与しているため、疲労破折を起こしにくい。
金属の模擬根管模型の中で、何回転 すると折れるかという試験を行っている。(条件:500min^{-1})

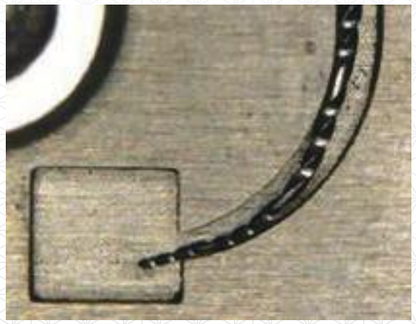



試験動画

複雑根管の治療をサポートする追従性

複雑な形状でも外弯・内弯に偏らない形成をサポート。

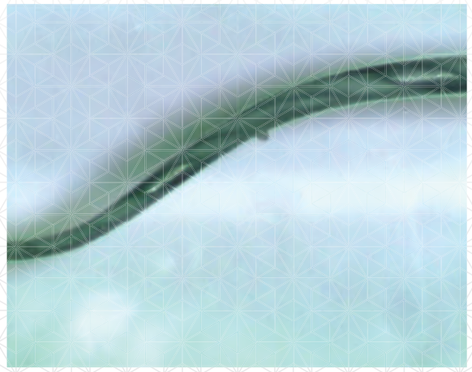

試験動画

使用方法

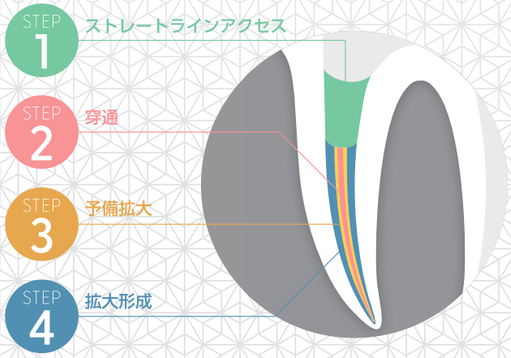

⚠
・ペッキングモーションで使用する。
・ファイルの交換ごとに洗浄・リキャピチュレーション(#10)を行う。
・フルレングス法で使用する。

STEP 1 ストレートラインアクセス

JIZAIオリフィスオープナー (025 14)

正回転 許容回転数:500min^{-1}以下 トルク設定値:3.0N·cm以下

STEP 2 穿通

Dファインダー(010 02)

または

グライドファインダー(010 03-02)

※ 石灰化・狭窄が激しい根管にはグライドファインダーを使用

STEP 3 予備拡大(グライドパス)

JIZAI Pre 013(013 04)

正回転 許容回転数:300min^{-1}以下 トルク設定値:1.0N·cm以下
※OTRモード 回転数:300min^{-1}以下 トルク:1.0N·cm以下

石灰化・狭窄、弯曲した根管の場合

JIZAI Pre 020(020 04)

正回転 許容回転数:500min^{-1}以下 トルク設定値:3.0N·cm以下
※OTRモード 回転数:500min^{-1}以下 トルク:1.0N·cm以下

STEP 4 拡大形成

JIZAI Ⅰ(025 04)/JIZAI Ⅱ(025 06)/JIZAI Ⅲ(035 04)

正回転 許容回転数:500min^{-1}以下 トルク設定値:3.0N·cm以下
※OTRモード 回転数:500min^{-1}以下 トルク:1.0N·cm以下

Ⅰ(025 04)

Ⅱ(025 06)

Ⅲ(035 04)

※トライオートZX2, ZX2+は、株式会社モリタ製作所の製品です。OTRモード及び設定値の詳細については、本製品の製造販売業者にご確認ください。
販売名:トライオートZX2　一般的名称:歯科多目的治療用モータ　医療機器の分類:管理医療機器　特定保守管理医療機器　医療機器認証番号:228AHBZX00040000　製造販売:株式会社モリタ製作所